

1129 醫療系列


WMRC輪 輪徑 × 輪寬 75 x 31mm

EAN  
TW-4112903001016

固定式腳輪，一體成型沖壓腳架—高級孔  
表面鍍鋅，底板式安裝裝置  
加強型熱可塑性塑膠輪芯、輪面  
輪子軸承—精密滾珠。

輪面：熱塑性塑膠（PA6）  
輪芯：熱塑性塑膠（PA6）

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

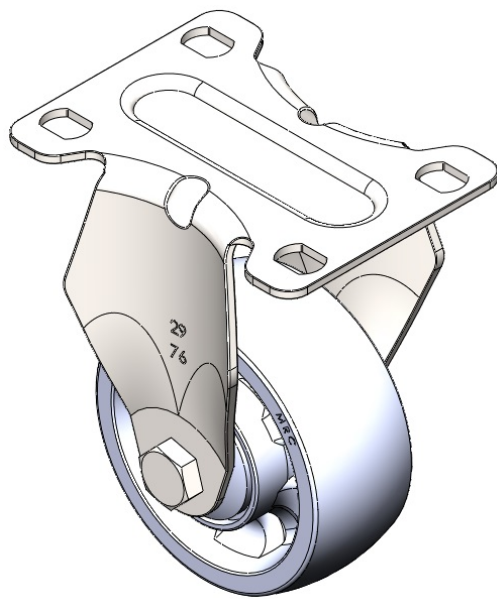

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                 |
| 輪徑                                                           | 75mm            |
| 輪寬                                                           | 31mm            |
| 輪子軸承                                                         | 搭配滾珠軸承的輪子       |
| 底板規格                                                         | 92 x 70mm       |
| 底板孔規格                                                        | 75 x 45mm   高級孔 |
| 底板孔徑                                                         | 12 x 9mm        |
| 總高                                                           | 113.5mm         |
| 硬度                                                           | 70±5° Shore D   |
| 荷重(動態)                                                       | 120kgs          |
| 荷重(靜態)                                                       | 180kgs          |
| 溫度                                                           | -25°C to +80°C  |
| 腳架樣式                                                         | 固定              |
| 不銹鋼                                                          | 否               |
| 導電                                                           | 否               |
| 抗靜電                                                          | 否               |
| 腳輪重量                                                         | 0.40kgs         |
| 測試標準                                                         | ISO22883        |


優勢簡覽

|      |       |
|------|-------|
| 滾動順暢 | ●●●●● |
| 靜音表現 | ●●○○○ |
| 保護地板 | ●●○○○ |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

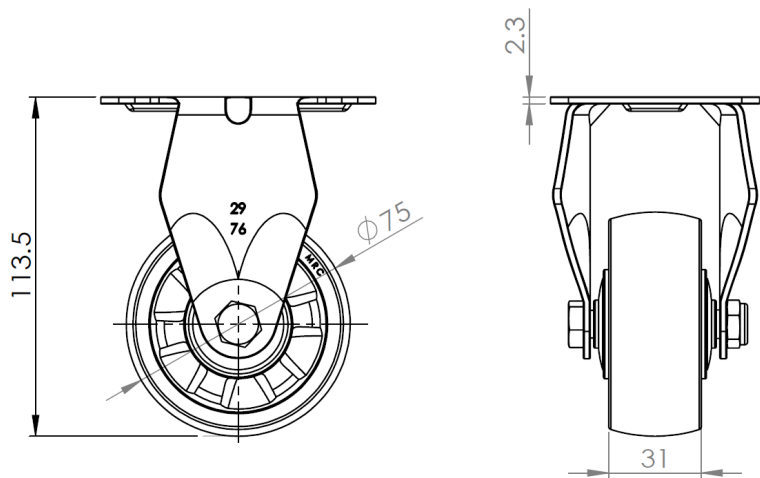

底板外觀尺寸2D圖檔

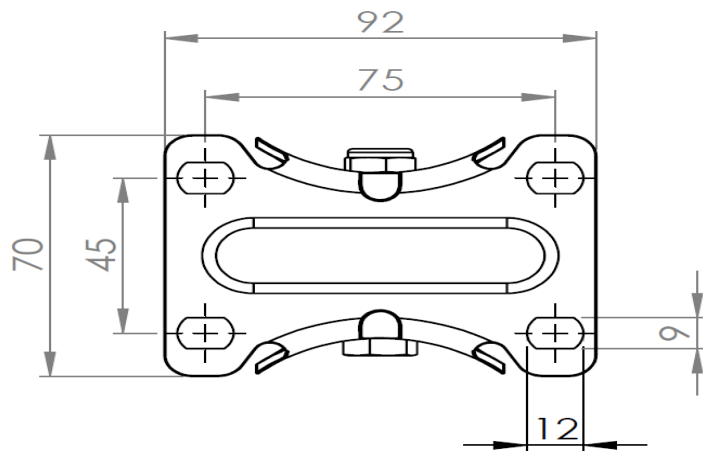

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。