



1129 醫療系列


电木轮 轮径 × 轮宽 100 x 34mm

EAN  
TW-4112904001032

固定式脚轮，一体成型冲压脚架—高级孔  
表面镀锌，底板式安装装置  
浸软织物的压缩合成树脂轮芯、轮面  
黑色，轮子—中管式。

轮面：浸软织物的压缩合成树脂  
轮芯：浸软织物的压缩合成树脂

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

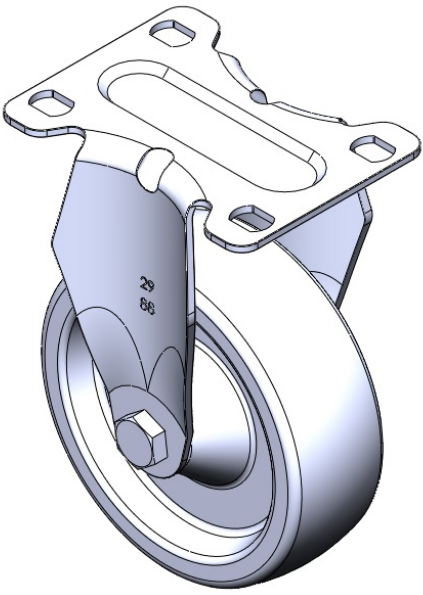

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                 |
| 轮径                                                           | 100mm           |
| 轮宽                                                           | 34mm            |
| 轮子轴承                                                         | 搭配中管的轮子         |
| 底板规格                                                         | 92 x 70mm       |
| 底板孔距                                                         | 75 x 45mm 高級孔   |
| 底板孔径                                                         | 12 x 9mm        |
| 总高                                                           | 136mm           |
| 硬度                                                           | 80±5° Shore D   |
| 荷重(动态)                                                       | 135kgs          |
| 荷重(静态)                                                       | 202.5kgs        |
| 温度                                                           | -20°C to +150°C |
| 脚架样式                                                         | 固定              |
| 不锈钢                                                          | 否               |
| 导电                                                           | 否               |
| 抗静电                                                          | 否               |
| 脚轮重量                                                         | 0.45kgs         |
| 测试标准                                                         | ISO22883        |


优势简览

|      |       |
|------|-------|
| 滚动顺畅 | ●●●●● |
| 静音表现 | ●●○○○ |
| 保护地板 | ●●○○○ |

脚轮外观尺寸2D图档

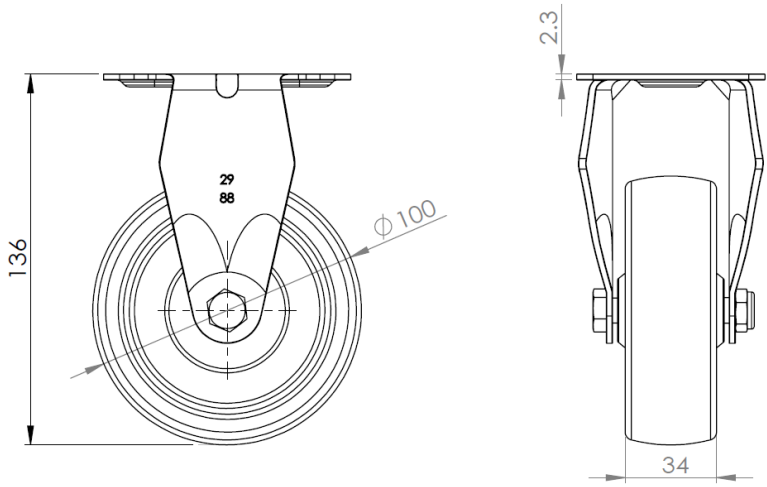

底板外观尺寸2D图档

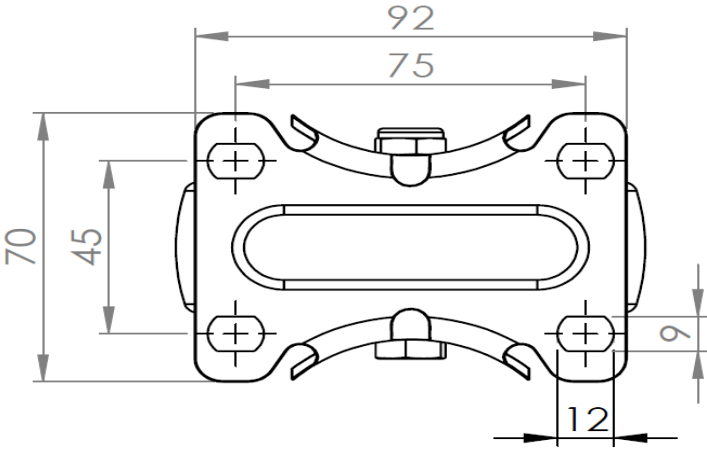

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。