

1129 醫療系列

尼龍輪 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm


EAN

TW-4112904001015

固定式腳輪，一體成型沖壓腳架—儀器孔  
表面鍍鋅，底板式安裝裝置  
熱可塑性塑料輪芯、輪面  
輪子—中管式。

輪面：熱塑性塑料 ( PA6 )  
輪芯：熱塑性塑料 ( PA6 )

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

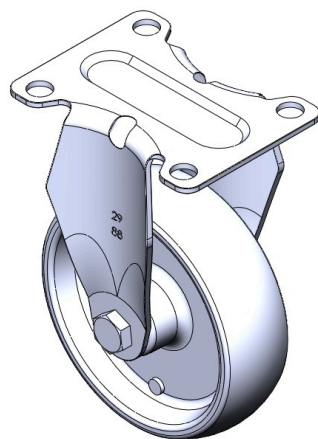

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 輪徑                                                           | 100mm          |
| 輪寬                                                           | 31mm           |
| 輪子軸承                                                         | 搭配中管的輪子        |
| 底板規格                                                         | 92 x 70mm      |
| 底板孔距                                                         | 72 x 53mm 儀器孔  |
| 底板孔徑                                                         | 10mm           |
| 總高                                                           | 136mm          |
| 硬度                                                           | 75±5° Shore D  |
| 荷重(動態)                                                       | 120kgs         |
| 荷重(靜態)                                                       | 180kgs         |
| 溫度                                                           | -20°C to +80°C |
| 腳架樣式                                                         | 固定             |
| 不銹鋼                                                          | 否              |
| 導電                                                           | 否              |
| 抗靜電                                                          | 否              |
| 腳輪重量                                                         | 0.45kgs        |
| 測試標準                                                         | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ● |
| 靜音表現 | ● ● ○ ○ ○ |
| 保護地板 | ● ● ○ ○ ○ |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

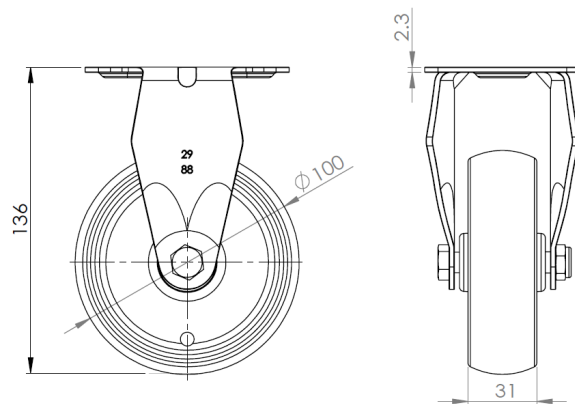

底板外觀尺寸2D圖檔

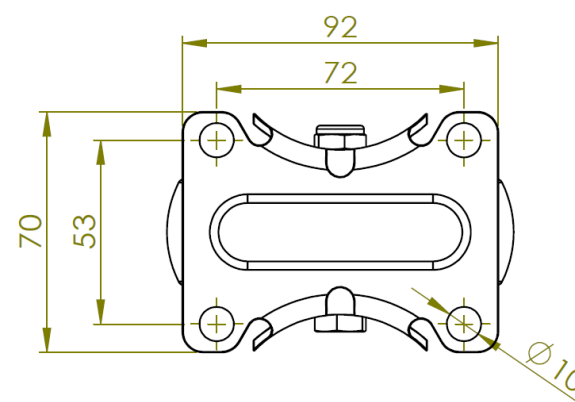

圖紙僅供參考一切以實體產品為主

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。